


TİROİD POZİSYONLAMA SİSTEMİ

- Tiroid ve guatr cerrahilerinde boynun istenilen pozisyonda kalmasını sağlar. Bası yarası ve doku zedelenmelerini önler
- Cerraha daha rahat bir görüş açısı sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Sırt bölgesinin eğimi ve boyun bölgesi için gerekli yükselti monoblok bir dizayna sahiptir.

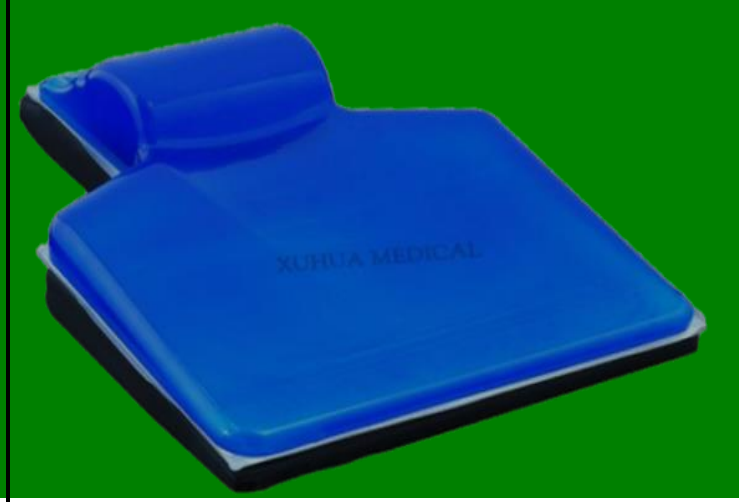


Pozisyonerin hastaya temas eden kısmı viskoelastik polimer jel olup; alt destek bölümü ise visko sünger esastıdır. Üst bölüm silikon, vinil, sünger ve köpük benzeri alerjik maddelerden mamül değildir. Ayrıca hava ve likit gibi hızla deforme olabilen bir yapıya sahip değildir.

Katı ve sıvı özelliklere birarada sahip olan ileri teknoloji bir malzeme olup; kesi alan yerlerde iç kısımdaki visko jel malzeme akmaz ve kaymaz. Tamir kitleri ile tamiri mümkündür.

-Model: XHT-9-2

-Ebatları : 48x39x9 cm

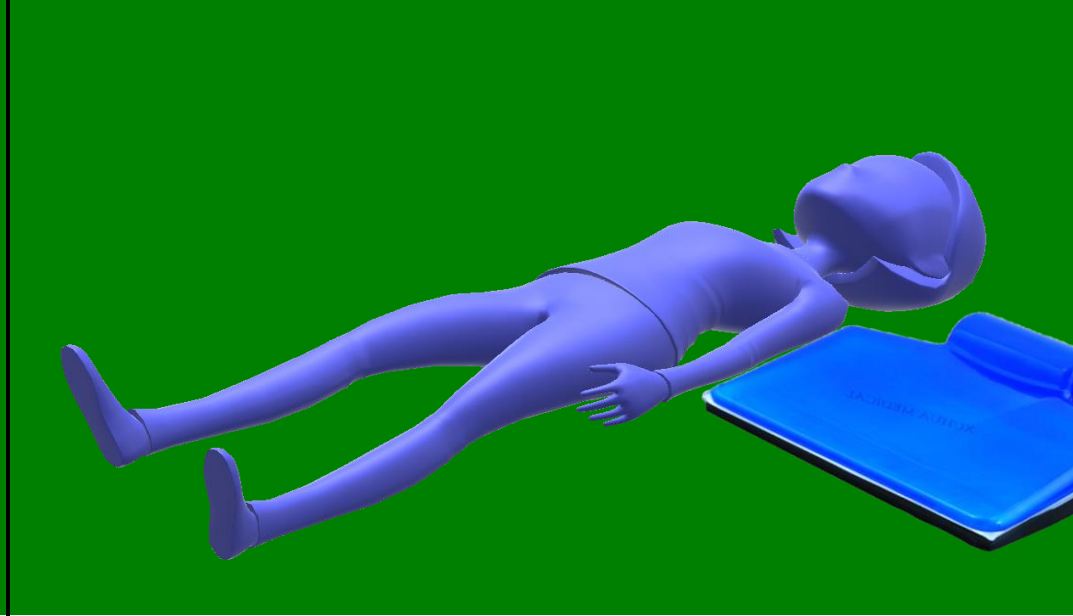

Jel Pedlerimiz özellikle uzun sürebilen ameliyatlarda ve post-op şartlarında basınçdan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmaları (dekübit yaralar) ile hipotansiyon riskini önleyecek yapıda üretilmektedir. Ürünlerin üst tarafı anti-bakteriyel bir kılıfa sahip olup; temizliği kolaydır. Ilık sabunlu ile temizlenebilir. Pozisyonerlerimiz -29 ile + 69 C dış ortam koşullarında bozulma; akma ve kayma olmadan çalışmaya devam eder.